

# SITA

Berührungslose Sauberheitskontrolle  
von Teileoberflächen auf filmische  
Verunreinigungen durch Fluoreszenz-  
messung



## SITA *CleanoSpector*

Sauberkeit kontrollieren – Schichtdicken überwachen

# SITA *CleanoSpector*

## Vorzüge

### Merkmale

- Prüfung und Justierung mit Gebrauchsnormen
- Mobiles und robustes Gerät für flexiblen Einsatz am Prozess und im Labor
- Intuitive Bedienung: einfaches, schnelles Messen und Kontrollieren
- Verschiedene Abstandshalter für die bequeme Kontrolle von unterschiedlichen Teilegeometrien verfügbar




### Einsatzgebiete

- Berührungslose Sauberheitskontrolle von Teileoberflächen aus Metall auf Knopfdruck
- Qualitätssicherung industrieller Reinigungsprozesse
- Schichtdickenmessung, z.B. von Korrosionsschutzöl, Primer

### Nutzen

- Höchste Produktqualität durch Grenzwertüberwachung
- Dokumentation geringster Verschmutzungen auf beliebig geformten Oberflächen
- Wirtschaftlichkeit durch Prozessoptimierung
- Erweiterbar zur kundenspezifischen Inline-Messung SITA clean line CI

### Messprinzip Fluoreszenz

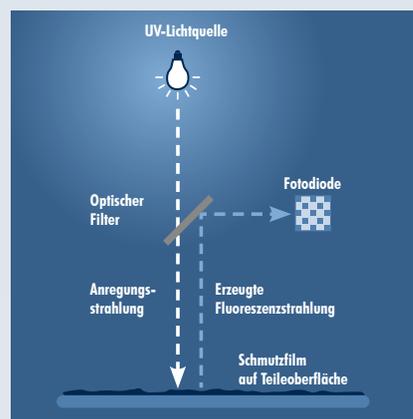

# Sauberkeit von Metallflächen prüfen

## Einsatzbereiche



- Sauberheitskontrolle von Metallteilen nach der Bearbeitung mit Fertigungshilfsmitteln (Überwachung, Optimierung und Steuerung von Reinigungsprozessen)
- Kontrolle von Funktionsflächen nach der partiellen Bauteilreinigung (Laserreinigung, Plasmafeinstreinigung, CO<sub>2</sub>-Schneestrahlen, ...)
- Kontrolle auf Trennmittelrückstände bei Aluminiumdruckgussteilen vor dem Dichtkleben
- Kontrolle der Sauberkeit von Getriebeteilen vor dem Laserschweißen
- Kontrolle von Teilen auf filmische Verunreinigungen in der Medizin- oder Vakuumtechnik
- Erfassen von Flussmittelresten und Verschmutzungen durch Vergussmasse in der Elektronikfertigung
- Oberflächenkontrolle auf elektrischen Kontakten nach dem Entschichten der Isolierung
- Schichtdickenkontrolle beim Korrosionsschutzöl- oder Primerauftrag



**Mit dem SITA CleanoSpector sichern Sie eine hohe Teilequalität vor sauberkeitskritischen Prozessen.**

# SITA *CleanoSpector*

## Technische Daten

### Fluoreszenzintensität

Messbereich	0...2.000 RFU (Relative Fluorescence Unit)
Messabweichung	max. 0,5 % des Messbereiches
Auflösung	0,1 RFU

### Sensoroptik

Anregung	365 nm, max. 150 mW
Detektor*	460 nm
Messpunkt*	D = 1 mm
Messabstand*	4,7 mm

\* bei Standardoptik

### Sauberkeit

Messbereich	0...100 %
Auflösung	0,1 %

### Schichtdicke

Messbereich	benutzerdefiniert
-------------	-------------------

### Stromversorgung

Li-Ion-Akku	3,6 V / 1.950 mAh min. 8 h Betriebsdauer
Netzteil / USB	100...240 V / 5 V
Leistungsaufnahme	max. 2,5 W

### Schnittstellen, Speicher, Abmessungen und Gewicht

USB	Datentransfer
Anzeige	LCD, beleuchtet
Anzahl Messprofile	254
Speicher	8.000 Messwerte je Profil
Abmessungen (HxBxT)	Basisgerät: 129x82x48 mm Sensorkopf: 95x50x30 mm
Gerätgewicht	530 g

## Windows-Software SITA-ProcessLog (optional)

- Geführte Teileprüfung mit grafischer Abbildung der Messpunkte auf Prüfflächen
- Dokumentieren und Bewerten der Teilesauberkeit
- Verwalten und Auswerten der gespeicherten Messdaten
- Prüfprotokolle und Messberichte unkompliziert und schnell erstellen
- Steuerung der Messung per PC
- Einfaches Erstellen und Verwalten von Messprofilen

## Kontakt

SITA Messtechnik GmbH  
Gostritzer Straße 63  
01217 Dresden  
Germany

Tel.: +49 (0)351 8 71 8041  
Fax: +49 (0)351 8 71 8464  
info@sita-process.com  
www.sita-process.com